



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА
КАМЕНИЦА**
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА



Комисија за јавну набавку
Ред. бр. ЈН-32/16
Број: 3384-4
Датум: 07.10.2016. године
Сремска Каменица

Комисија за јавну набавку образована решењем директора ИКВБВ број
3384-1
сачинила је

Додатно појашњење за јавну набавку ЈН-32/16 - Апарат за анестезију

06.10.2016. године примили смо допис заинтересованог лица, заведен у ИКВБВ под бројем 3473, за јавну набавку ЈН-32/16 - Апарат за анестезију у оквиру којег је наведено следеће:

1. Ставка 2: Апарат мора бити мобилан на колицима са централном кочницом.

Питање: Да ли је могуће понудити апарат који поседује кочнице на сваком точку посебно?

2. Ставка 10: Апарат има виšekратни канистер за CO₂ апсорбер запремине минимум 0,9 L.

Питање: Да ли је могуће понудити апарат који има виšekратни канистер за CO₂ апсорбер запремине минимум 0,7 L?

На основу члана 63. став 3, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.124/12, бр.14/15 и 68/15) достављамо вам одговор:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

2. Сода лајм (натрон креч) има веома битну улогу у функционисању кружног система апарата за анестезију. Сода лајм елиминише угљен диоксид који пацијент издахне, а такође греје и овлажује издахнути ваздух пацијента.

Запремина канистера соде лајма се одређује према области хирургије којом се установа бави тј. према дужини трајања операција. Институт за Кардиоваскуларне болести Сремска Каменица врши операције које неретко трају и до 6-7 сати.

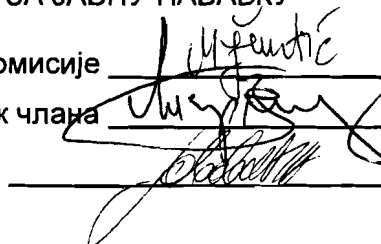
Наручилац је имао искуства са канистерима за соду лајм који су мање запремине од тражене (0,9 L), те се то у пракси показало као непрактично јер се сода брже трошила, те се дешавало да је потребно у току операције заменити соду лајм у канистеру јер је концентрација угљендиоксида коју пацијент удише превисока. Замена сода лајма у току операције је изузетно опасна по пацијента.

Наручилац је прописао тражену карактеристику у складу са својим објективним потребама водећи рачуна да траженом карактеристиком не ограничи конкуренцију и да омогући учествовање што већег броја понуђача.

Наведени одговор ће без одлагања бити објављено на Порталу јавних набавки и на Интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

1. Др Матеј Шунтић, председник комисије
2. Доц. др Лазар Велицки, заменик члана
3. Жарко Јововић, заменик члана

The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The first signature is for Dr. Matej Šuntić, the second for Assoc. Prof. Dr. Lazar Velicki, and the third for Žarko Jovović. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.